

**令和3年度
新型コロナウイルス感染症防止にかかる
用品等の購入助成事業実施要領**

一般社団法人 滋賀県トラック協会

1. 助成対象者

新型コロナウイルス感染症防止対策用品等（以下「対策用品等」という）を購入する一般社団法人滋賀県トラック協会（以下「滋ト協」という）の会員事業者に対し助成する。

※昨年度、本助成金を活用された事業者も、本年度（令和3年4月1日～令和4年2月28日）新たに対象商品を購入された場合は対象となります。

2. 予算額

650万円

3. 助成対象の対策用品等

助成対象の対策用品等は、交付要綱第2条の規程に適合するものとする。

・検査キット、マスク、手袋、体温計、除菌剤（液）など

4. 助成額

助成額は、会員事業者が令和3年度（令和3年4月1日以降）に対策用品等を購入した場合、1会員あたり2万円を限度として助成する。

但し、購入金額合計が限度額に満たない場合は、千円未満の端数は切捨てた額とする。

5. 申請期間

申請期間は、令和3年4月1日から令和4年2月28日までとする。

上記期間内であっても予算額に達した場合は、その時点までとする。

※申請は1事業者あたり年1回とする。

6. 交付要綱

「新型コロナウイルス感染症防止にかかる用品等の購入助成事業交付要綱」のとおり。

新型コロナウイルス感染症防止にかかる 用品等の購入助成事業交付要綱

令和 2年 6月 22日 制定

令和 3年 6月 23日 最終改正

(一社) 滋賀県トラック協会

(事業趣旨)

第1条 一般社団法人滋賀県トラック協会（以下「滋ト協」という。）は、新型コロナウイルス感染症防止対策として、会員事業者が同感染症防止対策用品等（以下「対策用品等」という。）を購入する費用に対して助成を行う。

なお、本事業は公益社団法人全日本トラック協会（以下「全ト協」という。）の「全国関連事業推進助成金交付要綱」に基づくものである。

(助成対象)

第2条 助成対象となる対策用品等は、下表のものとする。

助成対象	具体的事例
対策用品等	検査キット、マスク、手袋、ゴーグル、フェイスシールド、体温計、除菌剤（液）、飛沫防止シート（アクリル板）、空気清浄機、防護服、納体袋
関連して必要と認められるもの	別途全ト協が認めるもの

※昨年度、本助成金を活用された事業者も、本年度（令和3年4月1日～令和4年2月28日）新たに対象商品を購入された場合は対象となります。

(助成額)

第3条 助成金の交付額は、会員事業者が当該年度に新たに対策用品等を購入した場合、その費用について1会員あたり2万円を限度として助成する。

但し、購入金額合計が限度額に満たない場合は、千円未満の端数は切捨てた額とする。

(申請期間)

第4条 申請期間は、次条の申請する日の属する当該年度の2月末日までとする。

但し、予算に達した場合は、その時点までとする。

※申請は1事業者あたり年1回とする。

(交付申請及び助成金請求)

第5条 助成を希望する会員事業者は、様式1の「購入助成申請書および助成金請求書」に必要な事項を記入し、添付書類とあわせて滋ト協に提出する。

(助成金交付)

第6条 滋ト協は、前条の申請等の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは申請者に助成金を交付する。

(助成金の返還)

第7条 滋ト協は次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。

- (1) この要綱その他全ト協が定める事項に違反したとき
- (2) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
- (3) 第2条に定める対策用品等の購入費用に対し、滋賀県補助金等交付規則(昭和48年3月20日滋賀県規則第9号)に基づく補助金、負担金、利子補給金、その他反対給付を受けない給付金の交付を受けたとき

2 前項の規定により返還を命じられた会員事業者については、全ト協及び滋ト協が行う助成事業すべてに係る申請は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。

(その他必要な事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、別にこれを定める。

(附則) (令和2年6月22日制定)

第1条 本要綱は令和2年4月1日より適用する。

(附則) (令和3年6月23日制定)

第1条 本要綱は令和3年4月1日より適用する。

令和 年 月 日

一般社団法人 滋賀県トラック協会長 殿

(申請者)

住 所

氏名又は名称

代表者名

(担当者 :

TEL :

- -

印

)

新型コロナウイルス感染症防止にかかる用品等の
購入助成申請書および助成金請求書

新型コロナウイルス感染症防止にかかる用品等の購入助成事業交付要綱第5条に基づき、助成金の交付について下記の通り申請および請求します。

記

助成金申請 (請求) 額

		0	0	0
--	--	---	---	---

円 (千円未満切捨)

(内訳明細)

対 策 用 品 名	個数等内訳	購入金額 (税込)
		円
		円
		円
	合 計	円

(注1) 購入した用品名が記載された領収書等の写しを添付してください。

(注2) 申請は1事業者あたり年1回とする。

(振込先)

金融機関名		支店名	
口座種別	普通 ・ 当座	口座番号	
口座名義 (フリガナ)		



わずか**15分!**
高精度・新型コロナウイルス判定

研究用試薬



COVID-19 抗原検査キット

(JOYSBIO-covid-19-AGTK1)

10個 (10回分)


※10個単位での販売とさせていただきます。

一般価格 滋賀県

41,800円 (税込) → 39,600 (税込)

本検査キットは、新型コロナウイルスの感染の有無を検査することができるキットです。新型コロナウイルスに感染すると体内で生成されるウイルス特有のタンパク質（抗原）を検出することができます。万が一、体調に変化があった場合等に使用することで、今後とるべき行動の判断材料の一つにすることができます。

■製品の用途について

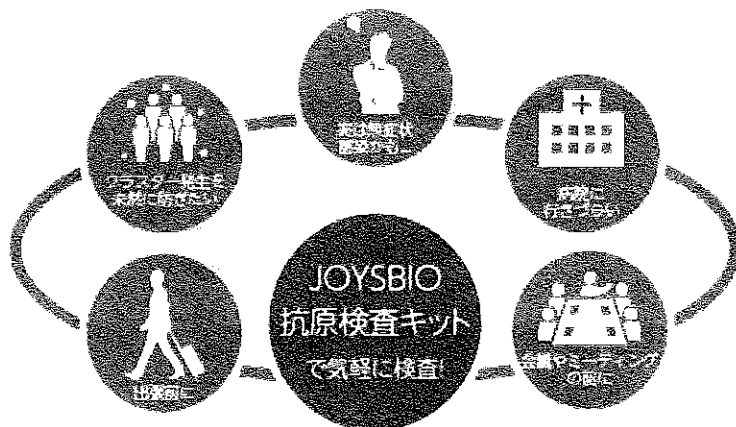

企業・個人で気軽に検査

本検査キットは、社員・家族間での新型コロナウイルス感染拡大を防止するための一つの目安となります。

例えばこんなとき、

今後とるべき行動の判断材料に

- ✓ 社員にあらかじめ配布し自宅に置いておくよう促し、出社前に症状がある場合は各自でチェック。
- ✓ 出張前や出張後に、関係者を一斉チェック。
- ✓ 帰省や旅行の前後に、家族みんなでチェック。

■臨床試験データで高い検出率評価を実現

- ☑ 感度:98.13%
【陽性一致=105/107】
- ☑ 特異度:99.22%
【陰性一致=382/385】
- ☑ 精度:98.98%
【(105+382) / 492 × 100】

本検査キットは、2020年10月～2021年1月にイタリアにて行われた492サンプルの臨床分析によると、PCR検査キットと比較して、検出感度は98.13%、特異度は99.22%と高い検出率評価を実現しています。

試薬試験結果	PCR検査		合計
	陽性	陰性	
陽性	105	3	108
陰性	2	382	384
合計	107	385	492

製品概要




JOYSBIO-covid-19-AGTK1



抗原検査と抗体検査の違い

抗原検査とは
ウイルスに感染した細胞が特異的に産生する抗原を検出して診断に導く検査のことを言います。PCR検査とともに、新型コロナウイルス感染症の確定診断にも用いられることがあります。
※本検査キットは、新型コロナウイルス感染を確定診断させるものではありません。

抗体検査とは
新型コロナウイルスに感染していたかどうかを調べる検査です。新型コロナウイルス感染後に形成されるタンパク質(抗体)が体内にあるかどうかを調べることができます。

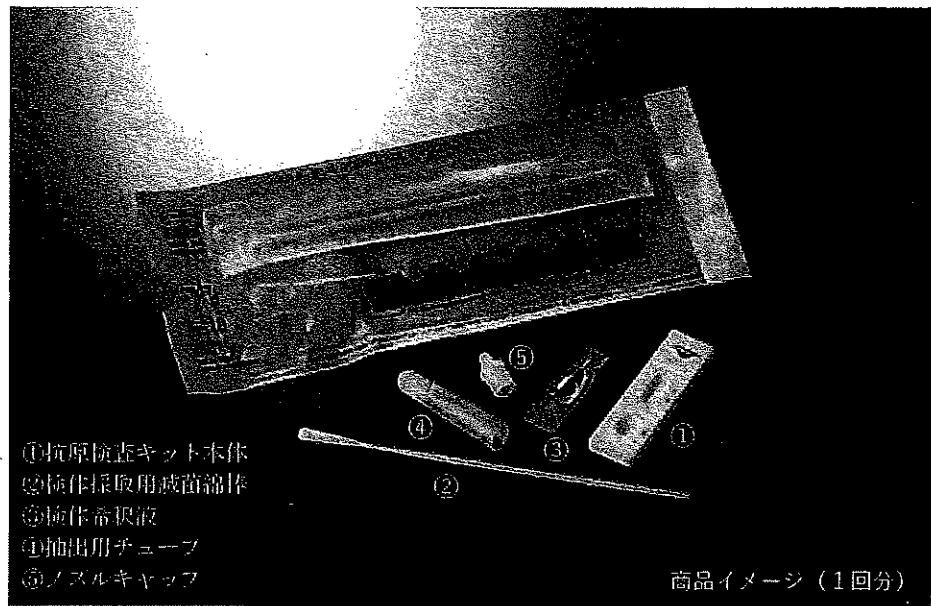

商品イメージ (1回分)

商品名	品番	適用サンプル	保管	使用期限
COVID-19 抗原検査キット	JOYSBIO-covid-19-AGTK	鼻腔ぬぐい液 (鼻腔スワブ)	2~30℃	製造日から 24か月 <small>※至多1年以上のものを納品します</small>

※本検査キットは新型コロナウイルス感染を確定診断させるものではありません。

【使用上の制限】

1. 本製品は定性検査のみ適用されます。
 2. 新型コロナウイルスの感染について、本製品の検査結果だけではなく、他の方法による検査結果とあわせて総合的に判断して下さい。
 3. 本製品は新型コロナウイルスと思われる症状が発症してから5日以内に使用して下さい。
 4. 5日目以降になると検査結果が正しく現れないことがあります。
- 本製品の使用は、研究用に限定して販売しております。
●本製品の使用により発生した損害及び損失について、弊社では責任を負いません。

検査手順

1 検体採取の準備

パッケージを開封し、中身をすべて取り出します。
「①検体希釈液」の入った容器の先端部分をねじって取り外し、中にある検体希釈液を全て「④抽出チューブ」の中に移します。

2 検体を採取します。(鼻腔ぬぐい液)

「②検体採取用滅菌綿棒」を鼻腔内(綿棒の先端が鼻腔入口部から奥に2~3cm程度)に差し込み、ゆっくり5回程度回転させます。同手順を両方の鼻腔で行います。
※粘膜の付着を必ず確認してください。
※この行為は必ずご自身で行ってください。

3 検体を抽出します。

綿棒を抜き、「④抽出チューブ」の中に差し込み、液体の中で20秒以上綿棒を上下に動かします。その後、チューブの底に押し当てて5回程度回し、チューブを外側から絞りがながら綿棒を抜き取ります。
※中身がこぼれないよう注意してください。

4 検査キットに検体を滴下します。

検体が入ったチューブに「⑤ノズルキャップ」をしっかりと差し込みます。
「①抗原検査キット本体」が清潔で平らな場所に設置されていることを確認し、チューブから検体をサンプル注入口に3滴程度滴下します。

5 検査結果を確認します。(検体滴下後、15~20分)

陽性	陰性	無効	
Cライン:○ Tライン:○	Cライン:○ Tライン:×	Cライン:×	Cライン:×

※検体滴下後、20分程度の結果で判定してください。
※「C」にラインが現れない場合は、新しい検査キットで再度検査してください。

Always Security OK

総合警備保障株式会社
本社 〒107-8511 東京都港区元赤坂1-6-6

ALSOK 0120-39-2413 (年中無休 24時間受付)

http://www.alsok.co.jp/

わずか**15分!**
高精度・新型コロナウイルス判定



COVID-19

抗原検査キット

10個 (10回分)

※10個単位での販売とさせていただきます。

一般価格

41,800円(税込) → **39,600円(税込)**

(全コロナイド)

検査キットの区分について

この抗原検査キットは、研究用試薬として、企業、個人間での取引が可能です。

体外診断薬

- 販売先：病院
- 確定診断者：医師
- 使用用途：検査キットの結果により、診断して
コロナウイルス感染を確定
- 実施可能な場所：病院、都道府県の定めた
保健所や施設
- 販売に必要な認可：薬事承認
- 販売免許：必要
- 該当製品：PCR検査キット/抗原検査キット等
(薬事承認有り)

研究用試薬

- 販売先：主に企業や個人
- 使用用途：検査キットの結果により、企業や個人
のコロナウイルス対策に対する1つの
判断材料として
- 実施可能な場所：指定なし
- 販売に必要な認可：不要 雑貨扱い
- 販売免許：不要
- 該当製品：抗体検査キット、抗原検査キット等
(薬事承認なし)


製品情報



JOYSBIO-covid-19-AGTK

内容：

- ①検査キット本体
- ②検体採取用スポイト
- ③検体希釈液
- ④抽出用チューブ
- ⑤滴下チップ
- ⑥唾液トレイ

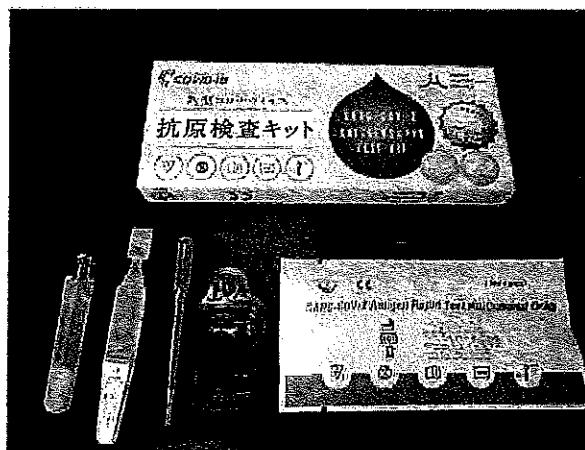

・CEマーク取得

抗原検査と抗体検査の違い


抗原検査とはウイルスに感染した細胞が特異的に産生する抗原を検出して診断に導く検査のことを言います。PCR検査とともに、新型コロナウイルス感染症の確定診断にも用いられることができます。

抗体検査とは新型コロナウイルスに感染していたかどうかを調べる検査です。新型コロナウイルスに感染すると形成されるタンパク質が体内にあるかどうかを調べることができます。

検査手順

検査結果目安


①



唾液の採取

唾液採取する前にリラックスし、頬と優しくマッサージしてください。指で頬を15～30秒間動かしてください。


②



検体の採取

スポイトを垂直に持ち、唾液採取容器から唾液を取り出して、3滴の唾液をチューブに入れてください。


③



チューブに希釈液を入れる

希釈液の先端部分をねじって取り外し、中にある希釈液を全てチューブの中に丁寧に移し替えます。

④



試験カセットに検体注入

テストキットを取り出し、清潔で平らな場所に設置します。チューブを優しく絞り、検体を検査キットの中に2滴～3滴注入します。

試験結果 20分以内に判定
注入後15分から20分の間に結果を確認します。

A C(+) T(-)

陰性 陰性結果は、検体にコロナウイルス抗原(Nタンパク質)がないか、コロナウイルス抗原のレベルが検出限界を下回っていることを示します。

B C(+) T(+)

陽性 陽性結果は検体にCOVID-19抗原(Nタンパク質)が存在することを示します。ウイルス抗原の存在を示しますが、病歴との臨床的相関および決定するために他の診断情報が必要です。

C C(-) T(-)

無効 どちらにも線が表示されません。不十分な液量または不適切な手順によりこの結果になる可能性があります。手順を確認し、新しいキットで手順を繰り返します。

D C(-) T(+)

無効 Tにのみ線が表示されます。不十分な液量または不適切な手順によりこの結果になる可能性があります。手順を確認し、新しいキットで手順を繰り返します。

注文情報

商品名	品番	適用サンプル	保管	使用期限
COVID-19 抗原検査キット	JOYSBIO-covid-19-AGTK	唾液検体	2～30℃	24か月

【使用上の制限】

1. 本製品は定性検査のみ適用されます。
 2. 新型コロナウイルスの感染について、本製品の検査結果だけでなく、他の方法による検査結果とあわせて総合的に判断してください。
 3. 本製品は新型コロナウイルスと思われる症状が発症してから5日以内に利用してください。5日目以降になると、検査結果が正しく現れないことがあります。
- 本製品の使用は、研究用に限定して販売しております。
●本製品の使用により発生した損害および損失について、弊社では責任を負いません。

この検査キットは体外診断薬とは違い、研究用試薬に分類される為、いかなる結果が検出されても確定診断に至ることはありません。万が一、体調に変化があった場合に自宅等でコロナウイルス感染の有無の判断材料の一つとして確認することができます。

〈製造元〉 JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.

〈販売元〉



ジャパンヘルスケアサービス株式会社
東京都中央区日本橋蛸船町1-36-2共和ビル4F
info@japan-hcs.com

(お問合せ)



株式会社 ブルースカイジャパン

TEL 06-6567-6171

〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川1-2-6 ZenII 501号

MAIL: info@b-s-j.co.jp URL www.b-s-j.co.jp

FAX: 06-6567-6172

一般社団法人滋賀県トラック協会会員様向け
COVID-19 抗原検査キット専用申込書

以下の内容でALSOKに申し込みます。

お申込み企業様 情報記入欄	郵便番号	—														
	所在地	フリガナ														
	企業名	フリガナ														
	ご担当者氏名	フリガナ														
電話番号	()	—														
商品の ご送付先住所	フリガナ															
ご注文内容	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名</th> <th>数量</th> <th>価格 (税込)</th> <th>ご注文数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JOYSBIO-covid-19-AGTK 抗原検査キット (唾液)</td> <td>1 セット (10 個)</td> <td>39,600 円</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>JOYSBIO-covid-19-AGTK1 抗原検査キット (鼻腔ぬぐい)</td> <td>1 セット (10 個)</td> <td>39,600 円</td> <td>個</td> </tr> </tbody> </table>				商品名	数量	価格 (税込)	ご注文数	JOYSBIO-covid-19-AGTK 抗原検査キット (唾液)	1 セット (10 個)	39,600 円	個	JOYSBIO-covid-19-AGTK1 抗原検査キット (鼻腔ぬぐい)	1 セット (10 個)	39,600 円	個
	商品名	数量	価格 (税込)	ご注文数												
	JOYSBIO-covid-19-AGTK 抗原検査キット (唾液)	1 セット (10 個)	39,600 円	個												
JOYSBIO-covid-19-AGTK1 抗原検査キット (鼻腔ぬぐい)	1 セット (10 個)	39,600 円	個													
※ 別途送料 600 円 但し、注文数 5 セット以上で商品送付先が同一 1 カ所の場合は、送料が無料となります。																

【本紙送付先】

Eメール : yoshida-m10@alsok.co.jp

FAX : (077) 523-5140

総合警備保障株式会社 滋賀支社 担当 : 吉田 正紀

〒520-0804 大津市本宮 2-37-4 ALSOK 大津ビル

TEL : (077) 523-1200 (平日 : 09 : 00 ~ 18 : 00)



2021.6.25 版